





Abstände in S2 Strahlzeit Mai 2025,
Abstände in Diagnose Kammer aus:
FRS S2 Setup von 23.2.2006,
Maße in mm

Projekt:
Strahlzeit Mai 2025

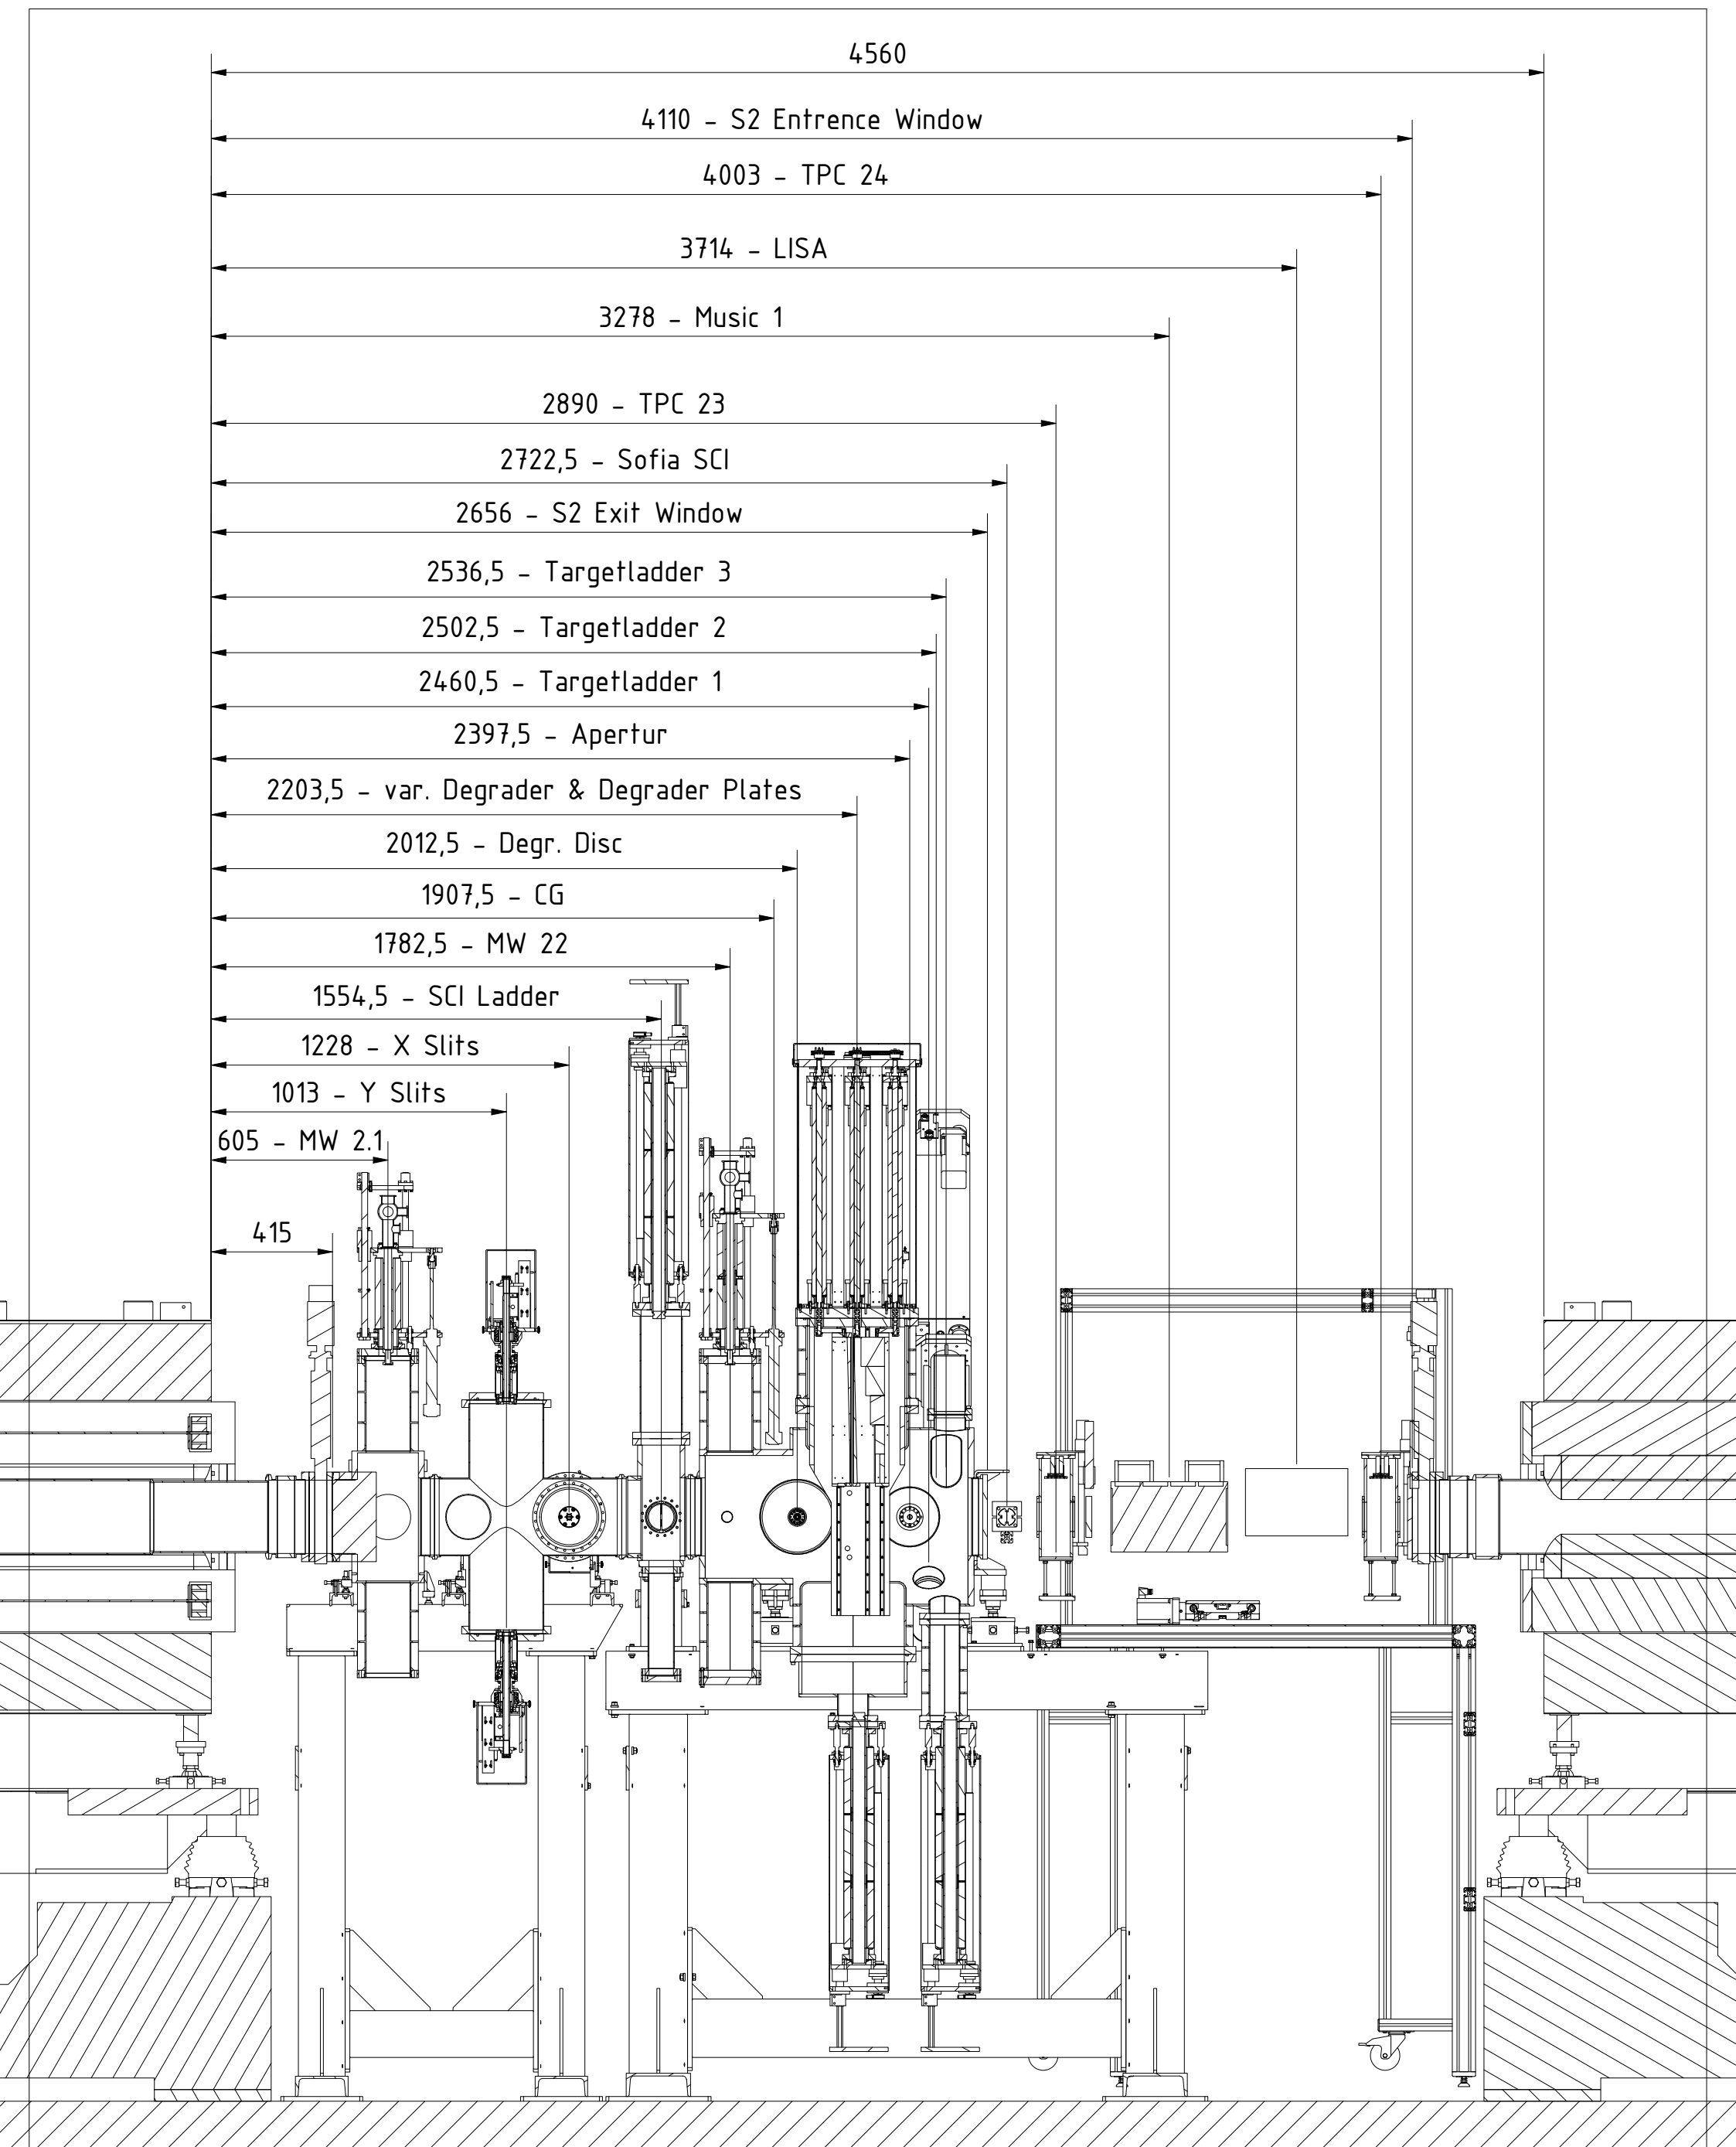

Freimaßtoleranzen nach
DIN ISO 2768 m

	Date	Name
Drawn		T.Weber
Checked		
Standard		



Zeichnung:

Material:

Stück:

Maßstab:
1 : 20

Format:
A3

Blatt:
1