





Abstände in S2 Strahlzeit Jan 2024,  
Abstände in Diagnose Kammer aus:  
FRS S2 Stetup von 23.2.2006,  
Maße in mm

Projekt:  
Beamtime May 2025

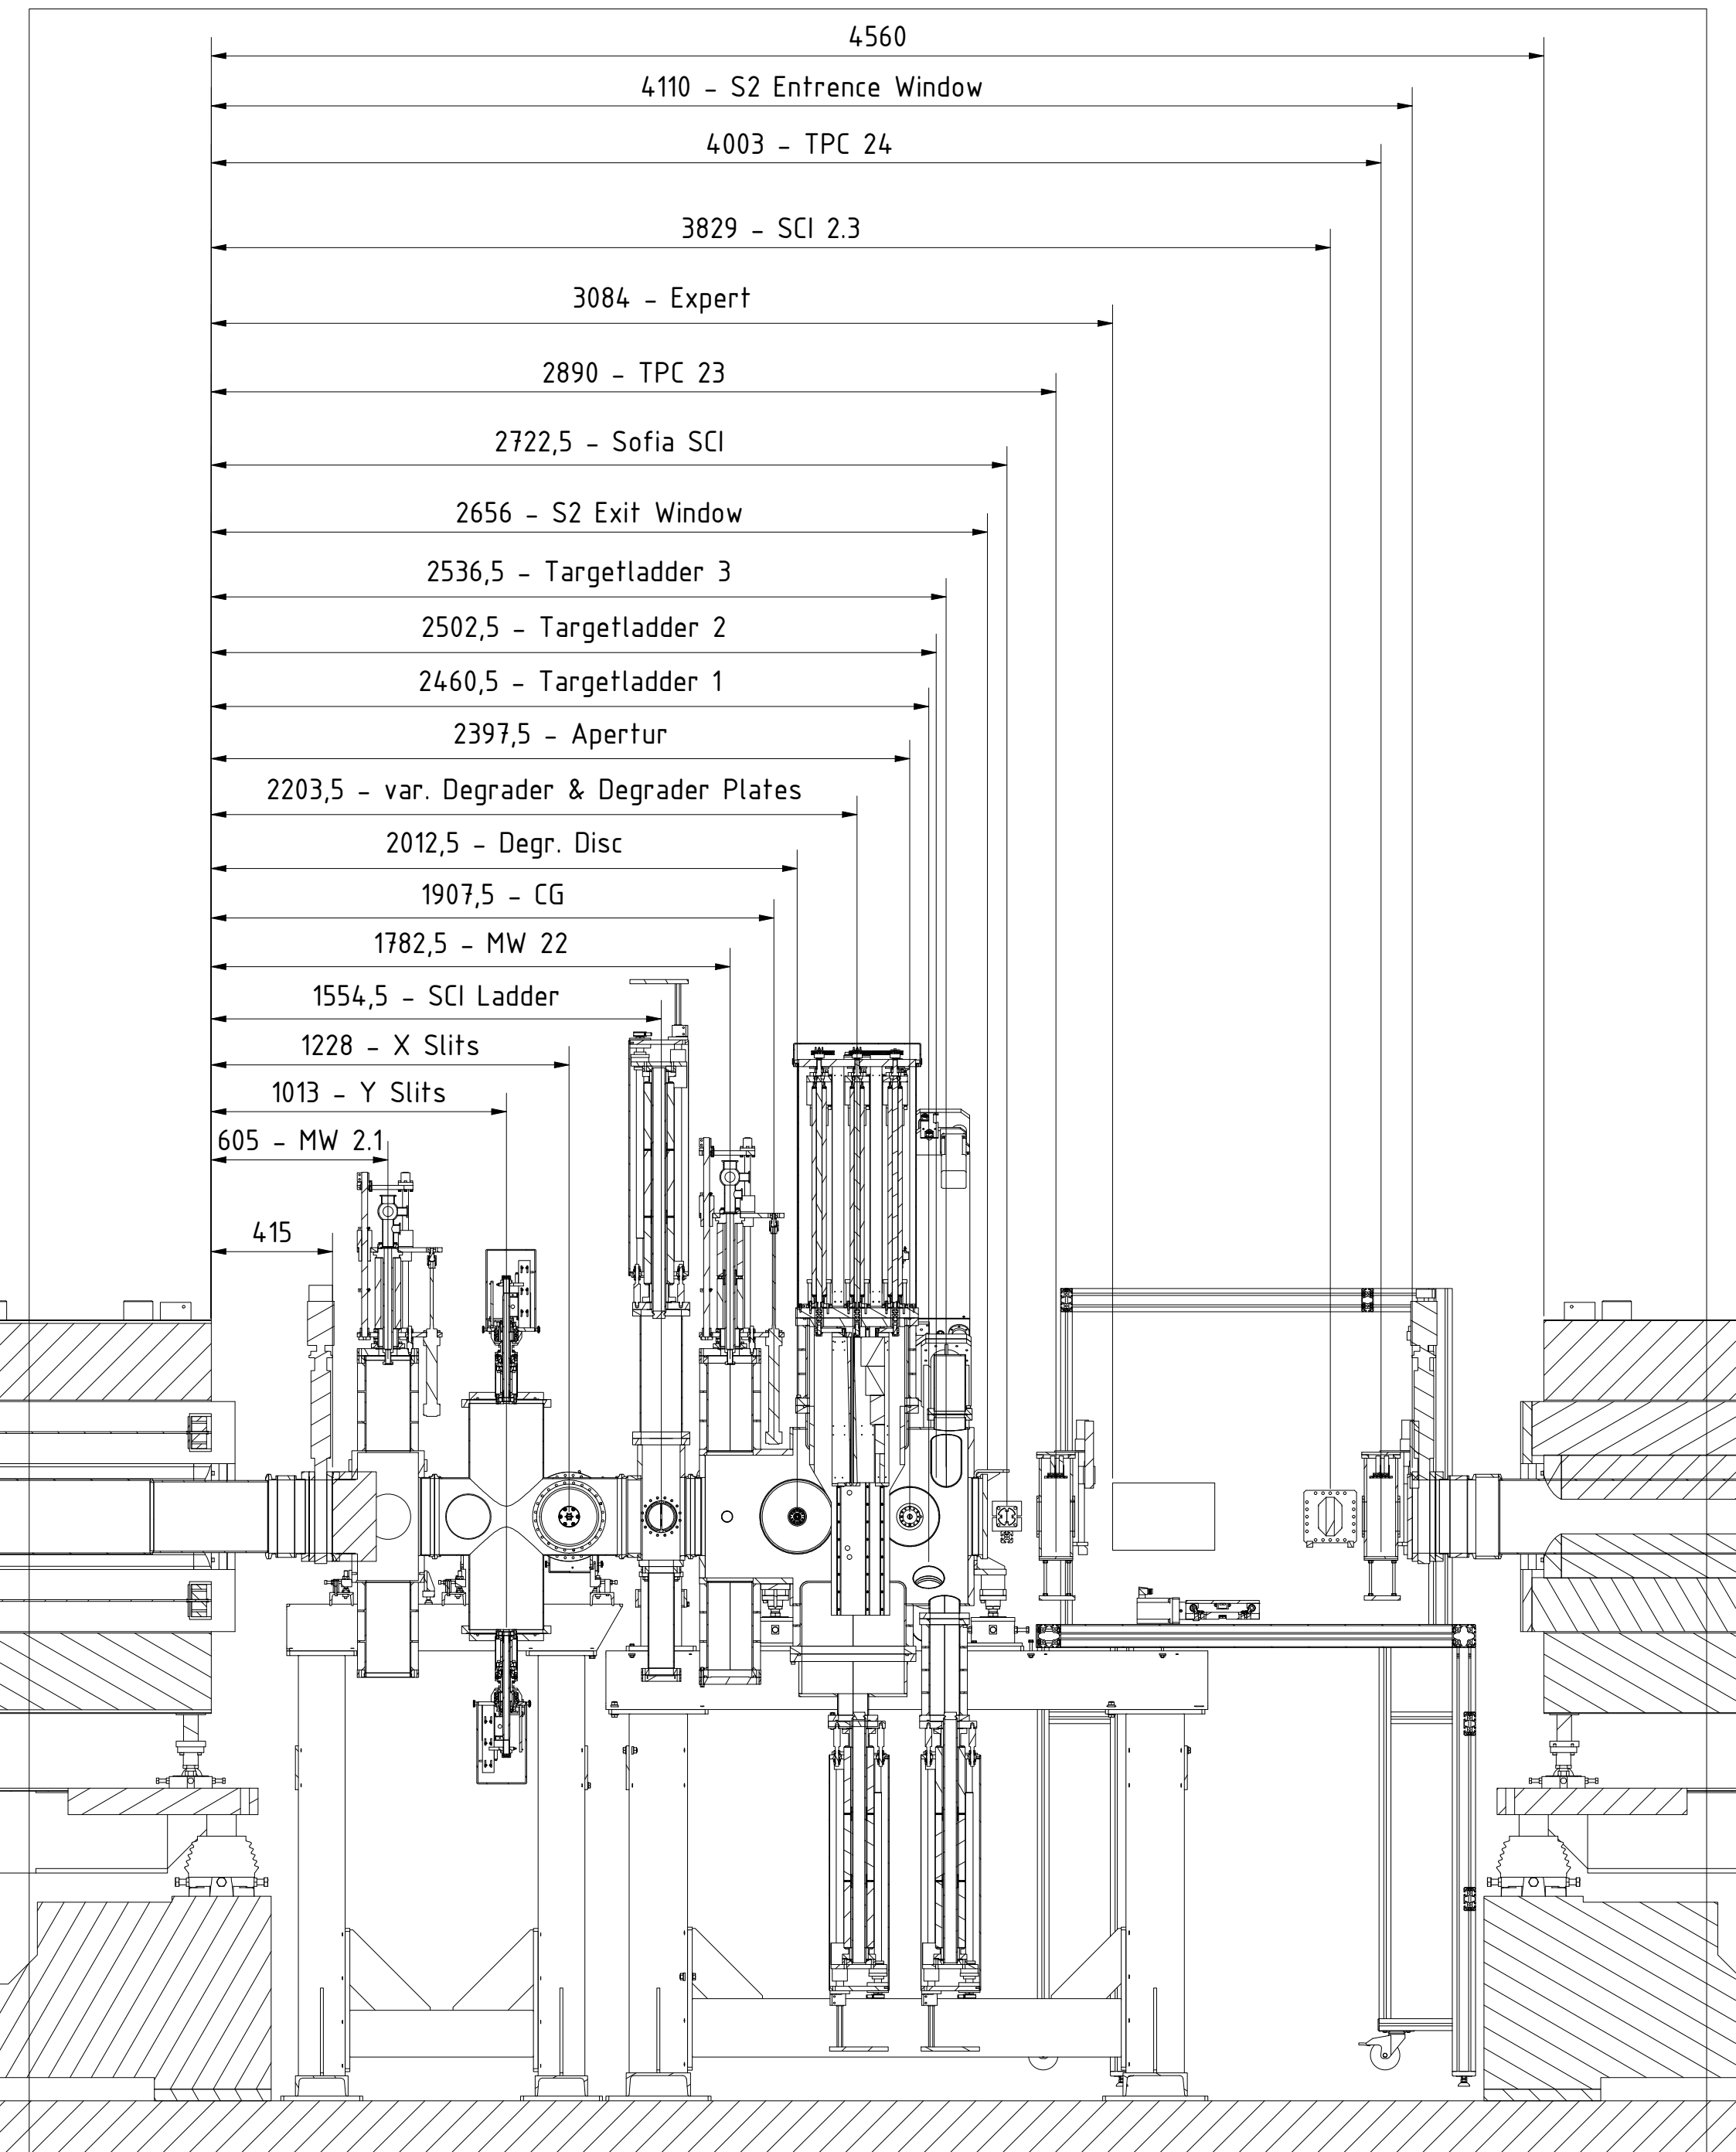

Freimaßtoleranzen nach  
DIN ISO 2768 m

|          | Date | Name    |
|----------|------|---------|
| Drawn    |      | T.Weber |
| Checked  |      |         |
| Standard |      |         |



Zeichnung:

Material:

Stück:

Maßstab:  
1 : 20

Format:  
A3

Blatt:  
1